

救急救助活動用感染防止衣（上下衣） 仕様書

豊 中 市 消 防 局

1. 品名 救急救助活動用感染防止衣（上下衣）

2. 仕様

1 材料

- (1) 生地一般 色ムラ、汚れ、異物の混入等品質を損なう欠点のないものとする。
- (2) 生地 別表 1 のとおり

2 形状・寸法

- (1) 上衣は、長袖、スタンドカラー面ファスナー付き、フロントファスナーのジャンパータイプであること。また、左右に脇ポケット・胸ポケット・左袖にペン刺しを取り付けること。
胸ポケットについては雨蓋付（マジック止め）であること。
- (2) 上衣のファスナーは、オートマチックスライダー機能を持つ YKK ファスナーとし、体液等の浸透を防止する形状であること。
- (3) 上衣の袖口はゴム等で絞込みであり伸縮性により着装時に密着するものとする。尚、袖口の直径は 5 c m（± 0. 5 c m）であること。
- (4) 脇ポケットの寸法は、縦 20cm（±2cm）×横 20cm（±2cm）寸法であること。
なお、右前の脇ポケットには、ペン挿し部分が設けてあること。

3 縫製

- (1) 各部の縫合は、縫い目の飛び、はずれがない優良なものとする。
- (2) 縫い代は、各部分に適した十分なものとする。
- (3) 糸調子は、縫い目が優良で縫い曲がりが目立たないものとする。
- (4) 縫い始め、縫い終わりの箇所（本縫い部分）は、返し縫をすること。

4 本部長標識

次に掲げる「 」内の文字を（ ）内の字体により、紺色再帰反射インクで印刷したものであること。

- (1) 文字は、下記の通りとする。

ア 左胸部に「豊中市消防局」（丸ゴシック体） 図 1 参照

イ 背部に「豊中市消防局」（丸ゴシック体）及び「TOYONAKA FIRE DEPT.」（Century 体） 図 2 参照

5 表示札

上衣のサイズ表示位置は、スタンドカラーの内側とし、ズボンのサイズ表示位置は右ウエスト部分とする。

3. 梱包

- 1 1 着ごとにポリプロピレンの袋に収納すること。
- 2 同サイズの 100 組を 1 個の収納箱に収納すること。

4. サイズ・数量 別紙に定める。

5. 同等品

- 1 同等品の申請は、期日までに契約検査課に連絡すること。
- 2 見本品及び使用材料の性質（仕様書）を添付すること。

※ 別表 1 規格一覧表のとおりのも。

6. 検 査 納品日において検品を実施する。

7. 納 期 令和 7 年 3 月 31 日まで

8. 納品場所

- 1 ライトブルーは新千里消防署東泉丘出張所（豊中市東泉丘 4-6-7）へ納品すること。
- 2 オレンジは消防局救急救命課（豊中市岡上の町 1-8-24）へ納品すること。

9. 担当者 豊中市消防局 救急救命課 中川 皓嗣（Tel06－6846－8416）

生 地 の 規 格 一 覧 表

生地は、帯電防止加工を施した下表の通りとし、汚れ等がないものを使用すること。

【ライトブルー】

生 地	区 分	規 格 等	備 考
	種類	表：ポリプロピレン不織布 中間：ポリエチレン透湿フィルム 裏：ポリエチレンとポリエステル芯鞘 構造不織布	
	目付	60 g / m ² (±5 g / m ²)	J I S L 1096
	色相	ライトブルー	
	引張強さ	縦：150 N / 5cm 以上 横：60 N / 5cm 以上	JIS-L-1096 カットストリップ法 試験片 50×200mm テストスピード 300mm / 分 つかみ間隔 100mm
	引張伸度	縦：50%以上 横：50%以上	
	引裂強さ	縦：20 N 以上 横：20 N 以上	JIS-L-1096 A-1 法 試験片 50×200mm テストスピード 300mm / 分
	耐水度	50kPa 以上	JIS-L-1092 B 法 静水圧法
	撥水度	4 点以上	JIS-L-1092 A 法
	透湿度	7,200 g / m ² / 24h 以上	JIS-L-1099 A-1 法
	アルコール浸透度	3 等級 (透湿指数 1 以下)	JIS T 8115 付属書 2 耐侵透湿試験 (ISO6530)
	人工血液バリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8060 D 法
	ウィルスバリア性	クラス 6 合格	JIS-T-8061 D 法

(ア) 各規格について、第 3 社試験機関が発行する試験成績書を有する事。

必要に応じ試験成績書の提示を求めます。

(参考商品名) 上衣 マックスガード 2765

下衣 マックスガード 2775

【オレンジ】

生地	区 分	規 格 等	試験方法
	種類	SMMS 4 層構造 (спанbond/メルトブロー/メルトブロー/спанbond のポリプロピレン 4 層構造不織布)	
	目付	60 ± 5 g /m ²	JIS L 1913
	色相	オレンジ	
	引張強さ	縦：60N 以上 横：60 N 以上	JIS L 1096 A 法
	引裂強さ	縦：50 N 以上 横：50 N 以上	JIS L 1096 C 法
	耐水度	600mm 以上	JIS L 1092 A 法 低水圧法

(ア) 各規格について、第 3 社試験機関が発行する試験成績書を有する事。


必要に応じ試験成績書の提示を求めます。

(参考商品名) 上衣 マックスガード 2 7 6 5 DJ

下衣 マックスガード 2 7 7 5 D

形 状 及 び 寸 法

【上衣】

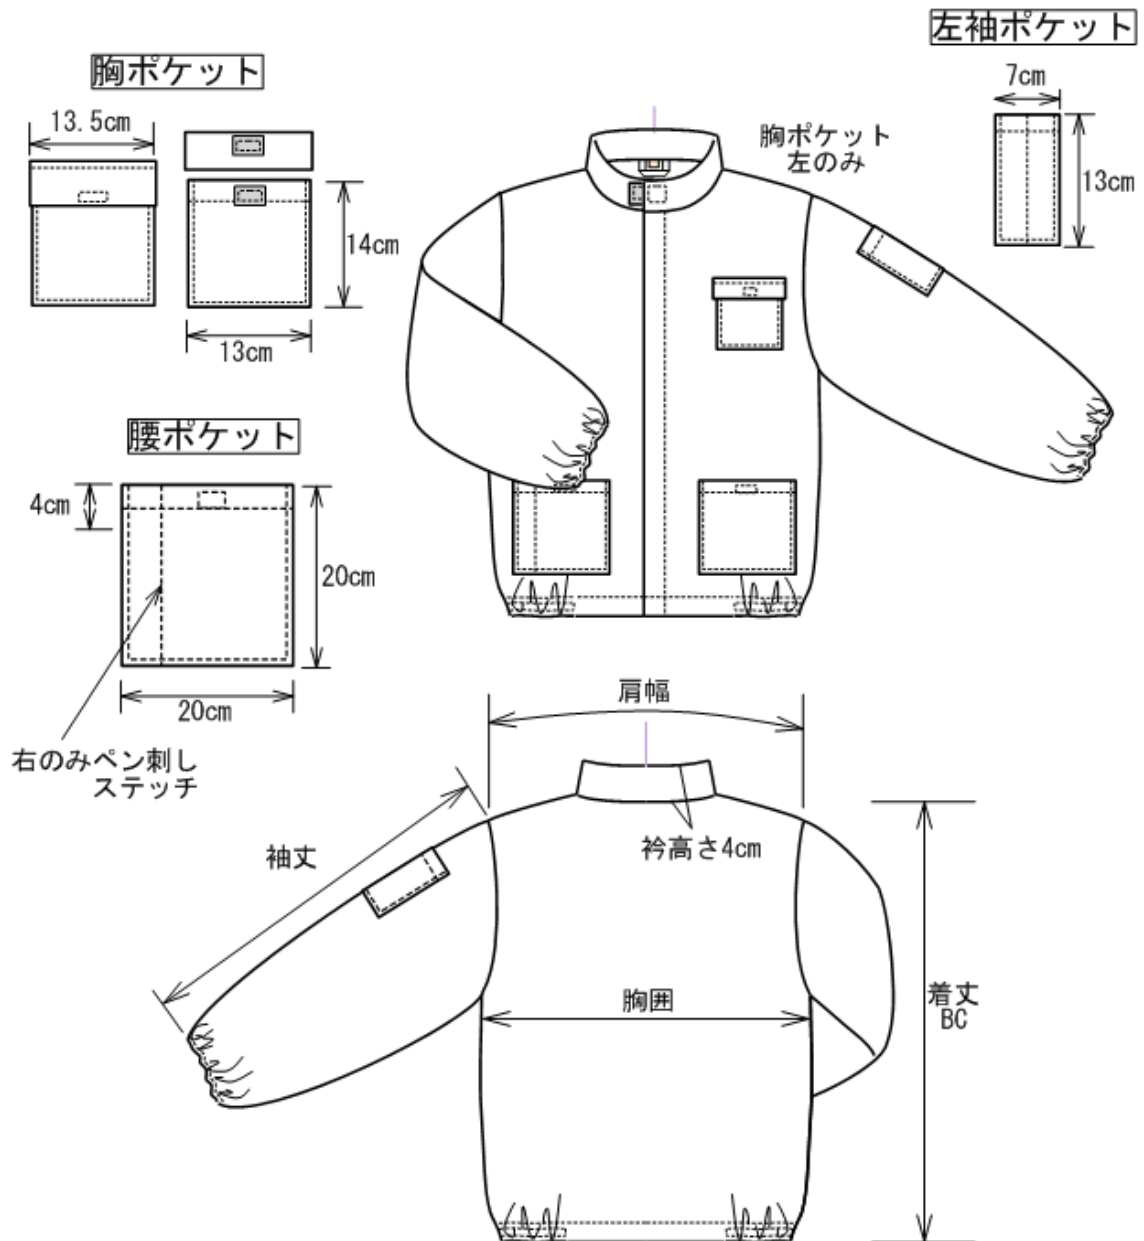


(単位 : cm ・ 許容差±5%)

サイズ別	S	M	L	L L	3 L
着 丈	65	66	69	73	76
肩幅	48	49	51	53	55
胸囲	114	120	126	132	138
袖丈	59	60.5	64.5	65.5	69.5

形状及び寸法

【下衣】

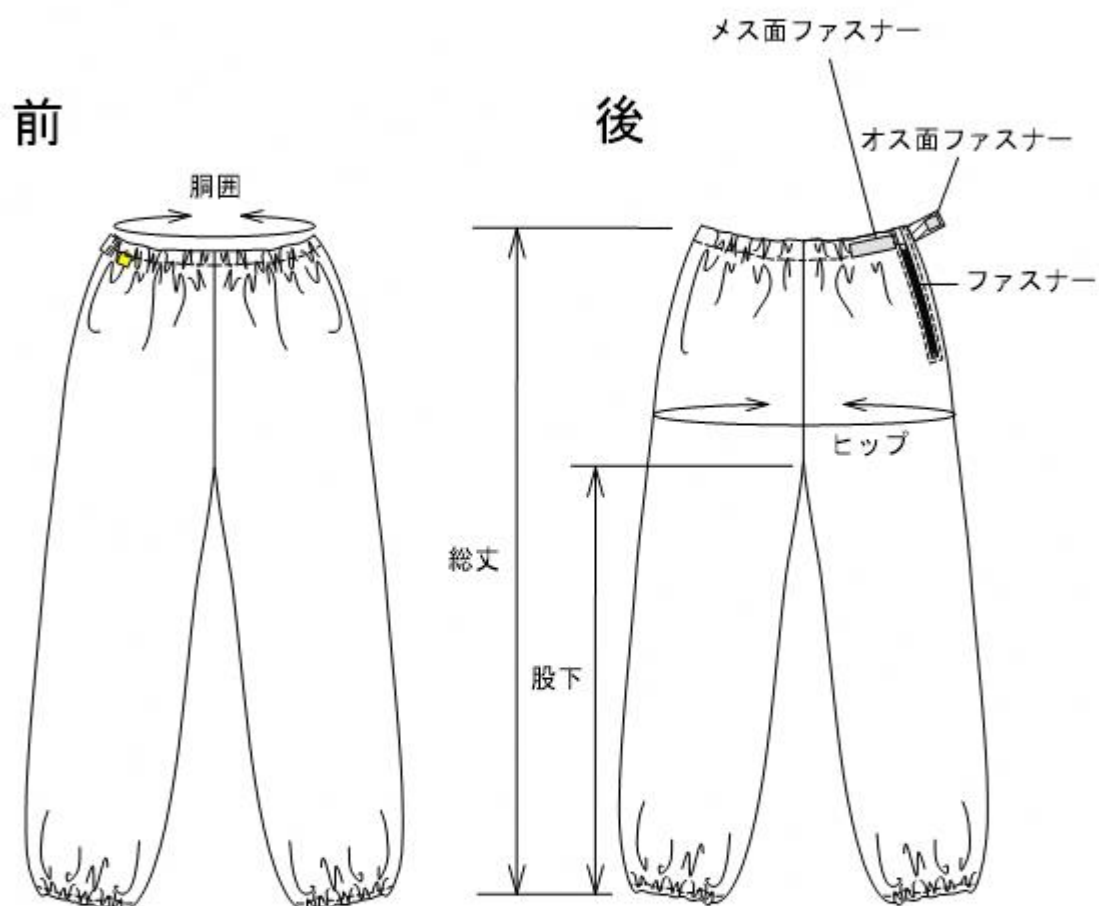

(単位：cm・許容差±5%)

サイズ別	S S	S	M	L	L L	3 L	4 L
総丈	111	115	119	123	126	129	131
ヒップ	106	112	118	125	135	145	151
股下	74	78	82	85	87	89	90
胴囲(ゴム上がり)	52	58	66	72	78	84	90
ファスナー長さ	30	30	30	30	30	30	30

サイズ・数量内訳表

【ライトブルー】

サイズ	上衣	下衣
3 L サイズ	0 枚	0 枚
L L サイズ	0 枚	0 枚
L サイズ	0 枚	500 枚
M サイズ	0 枚	2, 000 枚
S サイズ	0 枚	0 枚
合 計	0 枚	2, 500 枚

【オレンジ】

サイズ	上衣	下衣
3 L サイズ	0 枚	0 枚
L L サイズ	400 枚	400 枚
L サイズ	300 枚	300 枚
M サイズ	300 枚	300 枚
S サイズ	0 枚	0 枚
合 計	1, 000 枚	1, 000 枚

図 1 左胸部ネーム

豊中市消防局

図 2 背面上部ネーム

TOYONAKA FIRE DEPT.
豊中市消防局